

Dr. Werner Bergholz - „JEN NEŠKODNÉ TESTOVACÍ TYČINKY?!?“ (VIDEO 3min, CZ Titl + Přepis)


- CZ24 News | 17. prosince 2021

NĚMECKO: Werner Bergholz, bývalý profesor elektronického inženýrství a poradce německého parlamentu, představuje laboratorní výsledky zkoumání testovacích tyčinek (na covid) a v této souvislosti diskutuje o nálezů etylenoxidu.

[Originál](#) videa publikován: 14. prosince 2021

Přepis:

Etylenoxid je plyn, který se široce využívá v medicíně ke sterilizaci lékařského náčiní a produktů. Na první pohled není co namítat, ale existuje určité opodstatněné, nebo bylo opodstatněné podezření na základě starších publikací, že potenciální pozůstatky tohoto etylenoxidu, který je karcinogenní a mutagenní, se nachází na těchto testovacích tyčinkách (na covid). A podívejme se, to podezření bylo správné. Etylenoxid byl na nich detekován na úrovni 0,33 mg/kg, což je daleko za hranicí limitu 0,01 mg/kg.

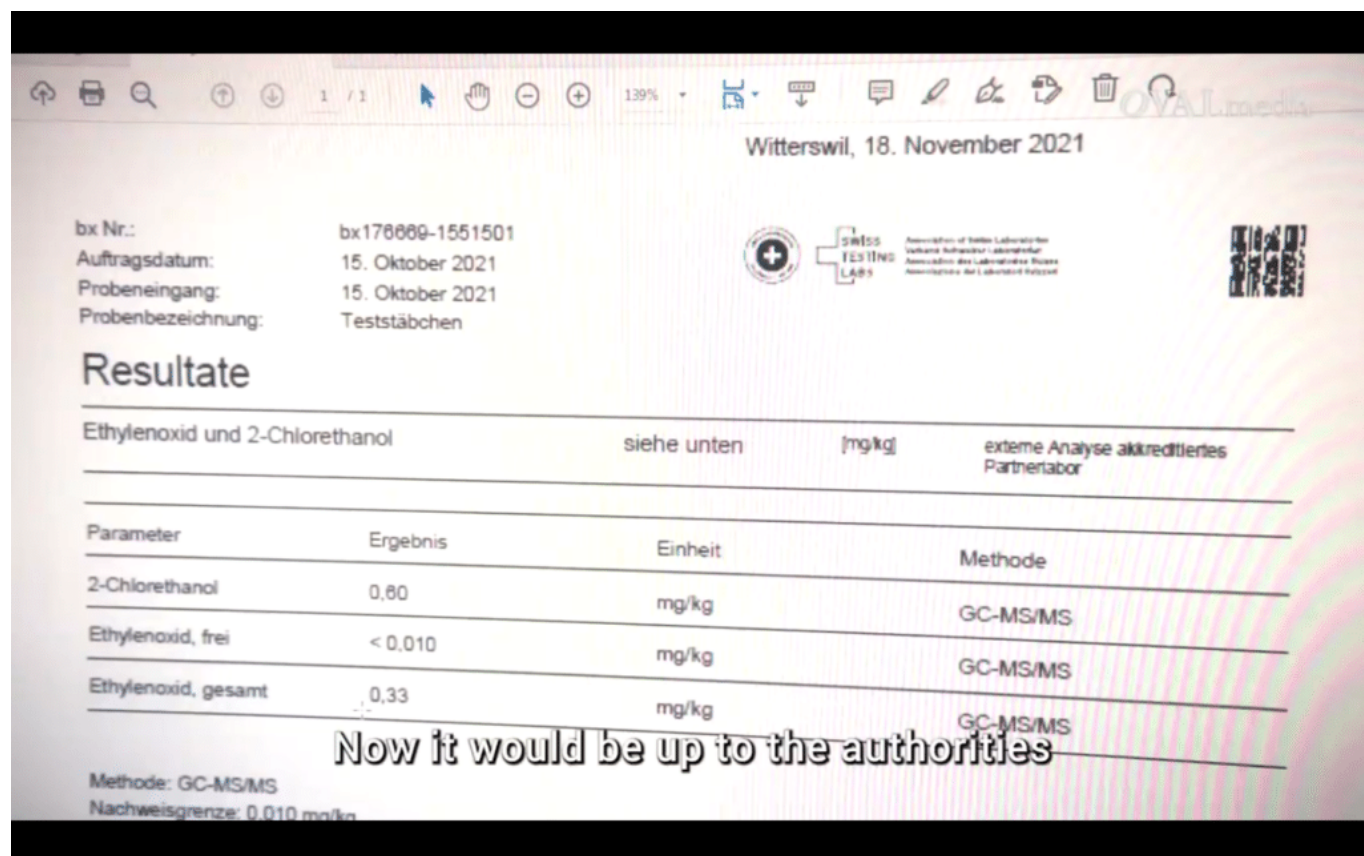

Witterswil, 18. November 2021

bx Nr.: bx176889-1551501
Auftragsdatum: 15. Oktober 2021
Probeneingang: 15. Oktober 2021
Probenbezeichnung: Teststäbchen

Resultate

Parameter	Ergebnis	Einheit	Methode
Ethylenoxid und 2-Chlorethanol	siehe unten	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor
2-Chlorethanol	0,60	mg/kg	GC-MS/MS
Ethylenoxid, frei	< 0,010	mg/kg	GC-MS/MS
Ethylenoxid, gesamt	0,33	mg/kg	GC-MS/MS


Methode: GC-MS/MS
Nachweisgrenze: 0,010 mg/kg

Now it would be up to the authorities

Kromě toho na nich vidíte 2-chlóretanol ve zhruba dvojnásobku toho množství. Tohle je rozpadový produkt, který je nebezpečnější než etylenoxid. Takže jsme jednoznačně za hranicí limitu. Je to

špatné? Dobrou zprávou je, že to není tak moc špatné, jak byste si mohli myslet. Ale špatnou zprávou je, že tam něco je. Je toho příliš mnoho?

Na tu otázku lze poněkud snadno odpovědět. Ano, rozhodně. Ale proč? Tady vidíte snímek z elektronového mikroskopu špičky takové testovací tyčinky.

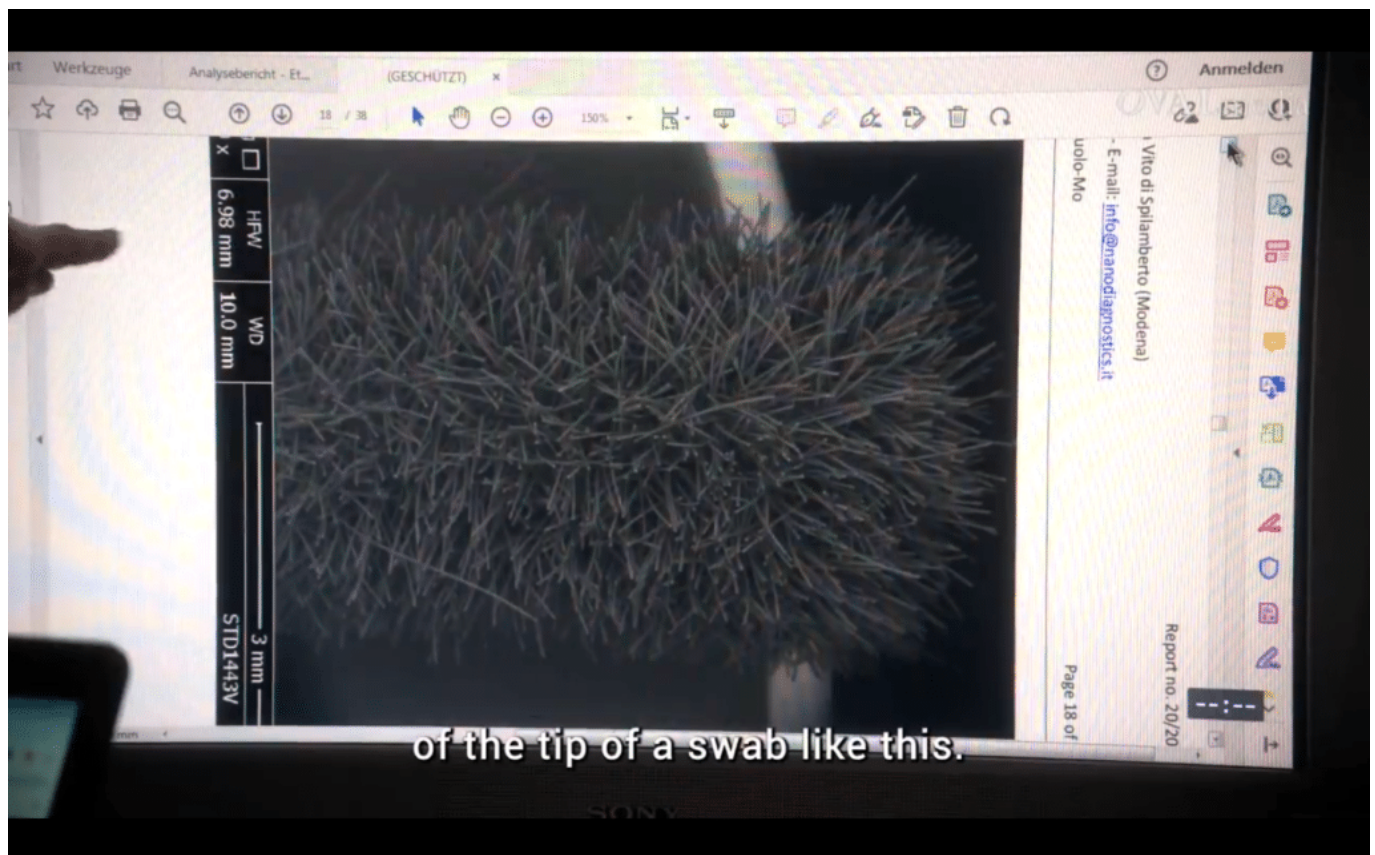

Investigativní zpráva, kterou mám u sebe, doslova uvádí, „vypadá to jako dikobraz“. Je to vyrobeno z plastu, který je klasifikován jako poněkud křehký. A laboratoř Bermpohl jednou provedla následující zajímavý experiment. Vzali zkumavku, vložili do ní tyčinku, znovu ji vytáhli a uvnitř zkumavky plavala spousta vláken z tyčinky.

Můžete říct, že se stačí na ně divně podívat, a některá se ulomí. Myslím si, že dá tedy rozum, že když teď udělám výtěr, tak ta vlákna budou mechanicky pod stresem, a dobrá část z nich skutečně uvízne někde ve sliznici. Tohle si ani nemůžete vymyslet. Tyto tyčinky se používají také pro „lízátkový test“.

Děti si je dávají do úst nebo je i žvýkají, což je ještě větší katastrofa. To pak z velké části zůstává v ústech, a je rozhodně spolknuto a jde to do těla. A samozřejmě, pokud je to karcinogenní, o několik let později se může projevit nějaký problém. Vážně nemám slov, jak očividně nedbalé byly úřady v zacházení s tímto v minulosti. Nyní je na úřadech, aby tohle systematicky vyšetřily. A pokud jsou testy vážně nezbytné, prosím, nechte si udělat plivací test ze slin, ale už ne výtěr z úst nebo nosu.

Překlad: David Formánek

Zdroj: otevrisvoumysl.cz